Endogal®


Catálogo

Sistema Endogal



Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

Un sistema de endodoncia revolucionario

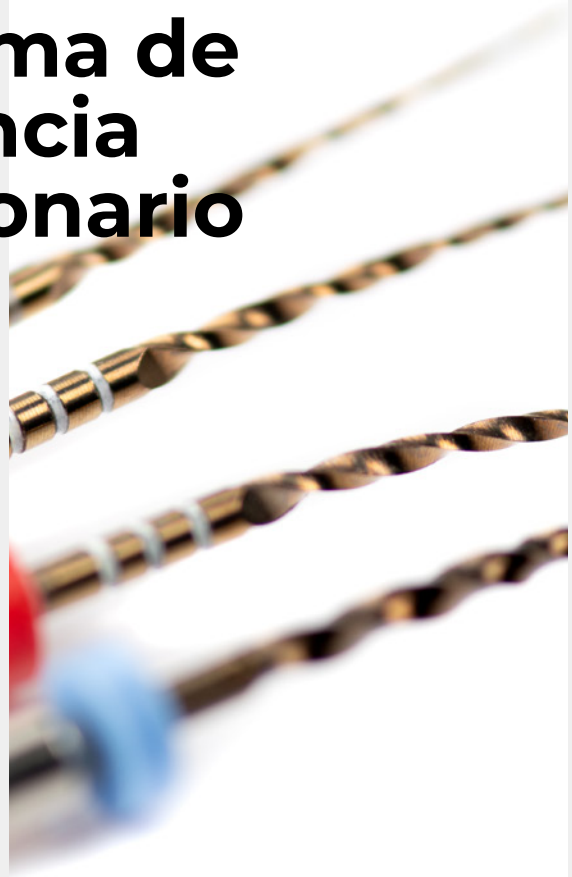

Endogal te acompaña en todas las fases de tu tratamiento de endodoncia, **desde la apertura, a la obturación,** pasando por **la instrumentación e irrigación.** Ofrecemos una solución para cada uno de tus tratamientos de endodoncia: conductos normales, difíciles y muy difíciles.

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

Índice de productos

Diagnóstico	**04**
Apertura cameral	**06**
Instrumentación	**08**
Limpieza y desinfección	**20**
Obturación	**24**
Cirugía apical	**30**
Accesorios	**32**

Diagnóstico



Preservar estructura dental es una de las premisas fundamentales para lograr el **éxito en el tratamiento de conductos.**

Una apertura conservadora, una determinación de la longitud de trabajo adecuada y un correcto glidepath son los pilares fundamentales para comenzar con un buen tratamiento endodóncico.

En nuestro apartado de diagnóstico podrás encontrar una sofisticada y dinámica herramienta. **El localizador de ápices Endogal** nos ofrece un diseño moderno y práctico, junto a una cómoda usabilidad que lo convierten en un **imprescindible para el diagnóstico en nuestros tratamientos endodóncicos.**

¿Cómo uso el localizador de ápices?

"Determina la localización de la constricción apical."



Localizador de ápices

Ref. A08 B

Instrumento indispensable para conocer con precisión la posición de la constricción apical y medición de longitud de trabajo del conducto en nuestras endodoncias.



Sonda | Ref. PPA082

Gancho | Ref. PPA083

Cable | Ref. PPA084

Clip | Ref. PPA085

Cargador repuesto | Ref. CHARGER

Repuestos del localizador de ápices

Apertura cameral



Las **puntas ultrasónicas** para apertura cameral ofrecen **máxima precisión y seguridad en los procedimientos endodónticos** gracias a su diseño fino que permite un control visual completo del proceso y una manipulación exacta. Su tecnología específica facilita el acceso a zonas de difícil alcance, reduciendo errores y mejorando la eficiencia clínica. Además, permiten una apertura más conservadora que preserva la integridad dentaria y garantiza resultados más predecibles y seguros.

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026



Dr. **Pablo Castelo Baz**

“Evoluciona tus tratamientos al siguiente nivel.”



Punta ultrasónica **ACCES 1** (1 Ud.)

Ref. EA1

- Long. **20mm**
- Bola diamantada.
- Búsqueda y localización de conductos calcificados.



Punta ultrasónica **ACCES 2** (1 Ud.)

Ref. EA2

- Long. parte activa estriada **9mm** - Conicidad **5%.**
- Localización MB2 y ocultos.
- Definición cámara pulpar.



Punta ultrasónica **ACCES 3** (1 Ud.)

Ref. EA3

- Long. parte activa estriada **8mm** - Conicidad **6%.**
- Localizar conductos y fragmentar calcificaciones.
- Retirar postes de fibra de vidrio y postes metálicos.

Instrumentación



En esta área podrás encontrar nuestro **sistema de instrumentación rotatoria:** un sistema caracterizado por su flexibilidad, seguridad y versatilidad; el cual ha sido desarrollado en base a la investigación, buscando facilitar el trabajo diario del clínico.

Endogal dispone también de instrumentos imprescindibles, tanto para la fase de permeabilización, como la **lima pre-k** o también un sistema único de **instrumentos rotatorios para Odontopediatría,** nuestras Endogal Kids. Todos ellos desarrollados por nuestros expertos clínicos.

Además, contamos con limas manuales como las **Limas K, K Flex, Limas H, NITI o Fresas Gates.**

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

¿Cuáles son las secuencias operatorias del sistema de instrumentación de Endogal?

CON. REC.

El **sistema de instrumentación** se puede emplear tanto en **rotación continua** a 350 rpm y torque 4 como en **rotación reciprocante** a 450 rpm y torque 4, *(120° sentido horario, 30° antihorario).* Sólo válido con motores donde se puede ajustar los ángulos de giro.



Instrumento rotatorio “A” (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2101503
25mm Ref. IRE 2501503
31mm Ref. IRE 3101503

Preinstrumentación mecánica.
Ø15, Conicidad **3%.**



Instrumento rotatorio “B” (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2102004
25mm Ref. IRE 2502004
31mm Ref. IRE 3102004

Instrumento de conformación obligatorio.
Ø20, Conicidad **4%.**



Instrumento rotatorio “C” (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2102504
25mm Ref. IRE 2502504
31mm Ref. IRE 3102504

Conductos difíciles o muy difíciles y preparaciones muy conservadoras.
Ø25, conicidad **4%.**

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

INSTRUMENTACIÓN

*Descubre más sobre nuestro **sistema de instrumentación.***

*Descubre un caso clínico con un **retratamiento de conductos.***



Dr. **Benjamín Martín Biedma**

"Versatilidad y seguridad a tu disposición."



Dr. **David Uroz Torres**

"Limas todoterreno para todos tus tratamientos."



Instrumento rotatorio "D" (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2102506
25mm Ref. IRE 2502506
31mm Ref. IRE 3102506

Instrumento básico de terminación. **Indicado para retratamientos.**
Ø25, conicidad **6%.**



Instrumento rotatorio "e" (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2103004
25mm Ref. IRE 2503004
31mm Ref. IRE 3103004

Instrumento de terminación cuando el gauging es 0,30 mm en preparaciones conservadoras.
Ø30, conicidad **4%.**



Instrumento rotatorio "E" (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2103006
25mm Ref. IRE 2503006
31mm Ref. IRE 3103006

Instrumento de terminación en gauging 0,30 mm.
Ø30, conicidad **6%.**



Instrumento rotatorio "F" (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2104006
25mm Ref. IRE 2504006
31mm Ref. IRE 3104006

Instrumento de terminación en gauging 0,35 o 0,40 mm.
Ø40, conicidad **6%.**



Instrumento rotatorio "G" (6 Uds.)

21mm Ref. IRE 2105006
25mm Ref. IRE 2505006
31mm Ref. IRE 3105006

Instrumento de terminación en gauging 0,45 o 0,50 mm.
Ø50, conicidad **6%.**



Instrumento rotatorio "X" (6 Uds.)

19mm Ref. IRE 1902509

Instrumento indicado para la eliminación de las interferencias coronales y remoción de gutapercha.
Indicado para retratamientos.
Ø25, conicidad **9%.**

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

¿En qué consiste nuestro sistema de instrumentación para dientes deciduos?

INSTRUMENTACIÓN

Limas pediátricas

Limas pediátricas



Dr. **Iván Varela Aneiros**

“El primer sistema de Europa creado para tratamientos en dientes deciduos.”











Instrumentos Endogal Kids

Ref. SIRKE

Este sistema es ideal para realizar pulpectomías que cumplan con los máximos criterios de calidad, lo cual llevará sin duda a conseguir un mayor índice de éxito en estos tratamientos.

Incluye

Lima EK1 (1 Ud.)

- **Ø25mm** - Conicidad **4%.**
- Un total de 8 espiras.
- Longitud parte activa 12 mm.
- Longitud total 17 mm.

Incluye

Lima EK2 (3 Uds.)

- **Ø25mm** - Conicidad **6%.**
- Un total de 8 espiras.
- Longitud parte activa 12 mm.
- Longitud total 17 mm.

Incluye

Lima EK3 (1 Ud.)

- **Ø30mm** - Conicidad **4%.**
- Un total de 8 espiras.
- Longitud parte activa 12 mm.
- Longitud total 17 mm.

Incluye

Lima EK4 (1 Ud.)

- **Ø40mm** - Conicidad **4%.**
- Un total de 8 espiras.
- Longitud parte activa 14 mm.
- Longitud total 19 mm.

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026



Endogal Starter Kit

Ref. IRE

Incluye:

- Instrumento rotatorio X 19x025, conicidad 9% (1 Ud.)
- Instrumento rotatorio A 25x015, conicidad 3% (1 Ud.)
- Instrumento rotatorio B 25x020, conicidad 4% (1 Ud.)
- Instrumento rotatorio C 25x025, conicidad 4% (1 Ud.)
- Instrumento rotatorio D 25x025, conicidad 6% (1 Ud.)
- Instrumento rotatorio E 25x030, conicidad 6% (1 Ud.)



Fresas Gates

N°1 | Ref. KGT1
N°2 | Ref. KGT2
N°3 | Ref. KGT3
N°4 | Ref. KGT4
N°5 | Ref. KGT5
N°6 | Ref. KGT6
Surtido | Ref. SGT

Indicadas para eliminar interferencias coronales o facilitar el acceso a instrumentos fracturados.



Limas K

Distribuidas en kits y surtidos de 6 Uds.

Kit Lima K Long. 21mm

Ø 06 Ref. K LK21006
Ø 08 Ref. K LK21008
Ø 10 Ref. K LK21010
Ø 15 Ref. K LK21015
Ø 20 Ref. K LK21020
Ø 25 Ref. K LK21025
Ø 30 Ref. K LK21030
Ø 35 Ref. K LK21035
Ø 40 Ref. K LK21040

Kit Lima K Long. 25mm

Ø 06 Ref. K LK25006
Ø 08 Ref. K LK25008
Ø 10 Ref. K LK25010
Ø 15 Ref. K LK25015
Ø 20 Ref. K LK25020
Ø 25 Ref. K LK25025
Ø 30 Ref. K LK25030
Ø 35 Ref. K LK25035
Ø 40 Ref. K LK25040
Ø 45 Ref. K LK25045
Ø 50 Ref. K LK25050

Kit Lima K Long. 31mm

Ø 06 Ref. K LK31006
Ø 08 Ref. K LK31008
Ø 10 Ref. K LK31010
Ø 15 Ref. K LK31015
Ø 20 Ref. K LK31020
Ø 25 Ref. K LK31025
Ø 30 Ref. K LK31030
Ø 35 Ref. K LK31035
Ø 40 Ref. K LK31040
Ø 45 Ref. K LK31045
Ø 50 Ref. K LK31050

Surt. Lima K Long. 21mm

Ø 35-45 Ref. SLK21 35-45
Ø 45-80 Ref. SLK21 45-80
Ø 50-60 Ref. SLK21 50-60
Ø 70-120 Ref. SLK21 70-120
Ø 90-140 Ref. SLK21 90-140

Surt. Lima K Long. 25mm

Ø 35-45 Ref. SLK25 35-45
Ø 45-80 Ref. SLK25 45-80
Ø 50-60 Ref. SLK25 50-60
Ø 70-120 Ref. SLK25 70-120
Ø 90-140 Ref. SLK25 90-140

Surt. Lima K Long. 31mm

Ø 35-45 Ref. SLK31 35-45
Ø 45-80 Ref. SLK31 45-80
Ø 50-60 Ref. SLK31 50-60
Ø 70-120 Ref. SLK31 70-120
Ø 90-140 Ref. SLK31 90-140

INSTRUMENTACIÓN

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026



Lima Pre-K

Presente en todas la secuencias de nuestro sistema. Sus características la hacen idónea en conductos de diámetro estrecho o en dificultades operatorias como bloqueos. Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.

Kit Lima Pre-K
Long. 21mm, Conicidad 1%

Ø 12 Ref. K LPK2101201

Kit Lima Pre-K
Long. 25mm, Conicidad 1%

Ø 12 Ref. K LPK250120

Kit Lima Pre-K
Long. 31mm, Conicidad 1%

Ø 12 Ref. K LPK310120



Limas K-Flexible

Su diseño nos proporciona una máxima flexibilidad. Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.

Kit Lima K Flexible
Long. 25mm

Ø 15 Ref. K LKF25015

Ø 20 Ref. K LKF25020

Surtido Lima K Flexible
Long. 25mm

Ø 15-40 Ref. SLKF25 15-40



Limas H

Empleadas para conductos rectos y retratamientos. Ideal para retirar el vástago de los obturadores. Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.

Kit Lima H
Long. 25mm

Ø 10 Ref. K LH25010

Ø 15 Ref. K LH25015

Ø 20 Ref. K LH25020

Ø 25 Ref. K LH25025

Surtido Lima H
Long. 25mm

Ø 15-40 Ref. SLH25 15-40

Ø 45-80 Ref. SLH25 45-80



Limas Manuales NiTi

Indicadas para la obtención del gauging o calibrado apical. Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.

Kit Lima NiTi
Long. 25mm

Ø 45 Ref. K LNT25045

Ø 50 Ref. K LNT25050

Surtido lima NiTi
Long. 21mm, Ø 15-40

Ø 15-40 Ref. S LNT21 15-40

Surtido lima NiTi
Long. 25mm, Ø 15-40

Ø 15-40 Ref. S LNT25 15-40

“Una sofisticada herramienta para tus retratamientos.”



Punta Ultrasónica Retreatment 1
(1 Ud.)

Ref. ER1

- Para extraer puntas de plata, material de relleno e instrumentos fracturados del tercio coronal.
- Long. **15mm** - Conicidad **6%**
- Gran facilidad de corte.
- Fabricada en acero.



Punta Ultrasónica Retreatment 2
(1 Ud.)

Ref. ER2

- Para extraer material de obturación, puntas de plata e instrumentos fracturados del tercio medio y coronal.
- Long. **20mm** - Conicidad **3%**
- Gran facilidad de corte con menor conicidad para mayor control.
- Fabricada en aleación de Titanio-Niobio.

INSTRUMENTACIÓN

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

INSTRUMENTACIÓN

¿Por qué MT 812 es el mejor motor del mercado?

Motor Endodóntico **MT 812** diseñado por el
Prof. Dr. **Yoshi Terauchi.**

"Una exclusiva tecnología de rotación + vibración."



Dra. **Yaiza Cuba González**

"Ergonómico, muy ligero y fácil de utilizar."



Portalimas

Ref. MFH

Ideal para introducir limas con una mayor visión y también a la hora de retirar gutapercha en los retratamientos.
Además transforma tus limas manuales en mircoopeners y microdebriders.



Motor Endodóntico MT 812

Ref. MOTOR 812 MT

Mejora la eficiencia y seguridad a la hora de hacer un retratamiento, retirar gutapercha, retirar instrumentos, sobrepasar escalones y realizar un sellado con MTA.

- Permite la obturación de conductos con MTA con su programa específico y su cabezal con movimiento vertical.
- Programa específico para sobrepasar escalones.
- Localizador incorporado.
- Motor con vibración sónica.



Motor de endodoncia

Ref. MOTOPEX

- Se emplea para la conformación de los conductos radiculares.
- Rotación continua y reciprocante.
- Localizador incorporado.
- Cabezal en miniatura ajustable 360°.
- Pantalla OLED digital.
- Batería de larga duración.
- Motor libre totalmente ajustable.



Funda cabeza Endo Radar Plus y Motopex |
Ref. 28-WA008



Cable Mini USB Motor Motopex |
Ref. 28-CAB006



Cabeza Motor Endodoncia |
Ref. 28-ME004



Transformador Motor Endo Motopex / AI Motor |
Ref. 28-TRA009

Limpieza y desinfección



Todo lo necesario para la realización de una correcta irrigación y limpieza del conducto.

Endogal pone a tu disposición múltiples herramientas que te facilitarán el trabajo durante la fase de **irrigación y limpieza.**

Dentro de esta categoría encontramos herramientas como la **punta ultrasónica** para **activar el irrigante** y **generar una fuerte cavitación.**

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

Descubre nuestros TIPS para realizar una irrigación efectiva.



Dra. **Sandra García Varela**

"Sencillo de utilizar en tu día a día clínico."



EDTA 17% Líquido

Ref. EDTA17

El EDTA Líquido al 17% es empleado para la limpieza del conducto radicular y la remoción del barrillo dentario.

- Suministrado con **1 jeringa** y **3 puntas.**

- Cada bote contiene **100ml.**



Jeringas para irrigación (100 Uds.)

Ref. 55LL

Jeringas empleadas para realizar irrigación durante el tratamiento de endodoncia. Son jeringas con luer-lock, es decir, se fijan a la aguja mediante una rosca para impedir que se suelten durante la irrigación.

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026



Agujas

Nuestras agujas para irrigación son adecuadas para una correcta limpieza del conducto. Su salida lateral posibilita una menor presión en la punta y un adecuado flujo por todo el conducto.

Half Cut 27G (100 Uds.)
Ref. NDH27G

- Diámetro externo ≈ **0,40 mm**
- No estéril.

Half Cut 30G (25 Uds.)
Ref. NDH30G

- Diámetro externo ≈ **0,30 mm**
- No estéril.



Punta ultrasónica para irrigación (4 Uds.)

Ref. EUI

- La punta de ultrasonidos es ideal para la remoción de residuos, bacterias así como para aumentar la desinfección y la remoción del barrillo dentario.
- Long. **21 mm** - Conicidad **Ø20.**
- Distribuidas en kits de 4 unidades.
- Corriente acústica que produce la disrupción de los biofilms
- Cavitación: debilitamiento del biofilm



Puntas de papel (200 Uds.)

Empleadas para secar el conducto radicular tras la irrigación. Disponibles en diferentes diámetros y conicidades.

Conicidad 4%		**Conicidad 6%**	
Ø 20	Ref. PP 02004	Ø 20	Ref. PP 02006
Ø 25	Ref. PP 02504	Ø 25	Ref. PP02506
Ø 30	Ref. PP 03004	Ø 30	Ref. PP 03006
Ø 35	Ref. PP 03504	Ø 35	Ref. PP 03506
Ø 40	Ref. PP 04004	Ø 40	Ref. PP 04006
Ø 50	Ref. PP 05004	Ø 50	Ref. PP 05006

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Obturación



A la hora de llevar a cabo la obturación del conducto radicular es importante contar con materiales e instrumental que nos garantice un procedimiento seguro y eficaz.

Endogal dispone de las herramientas necesarias para llevar a cabo procedimientos de obturación termoplástica, utilizando nuestro **horno** junto a los **obturadores de vástago de plástico** y de técnica de Onda Continua gracias a nuestro **sistema de obturación inalámbrico.**

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

Descubre como hacer la técnica de onda continua.



Dra. **Míriam Teulé Trull**

"Rápido, ergonómico y fácil de emplear."



Sistema de Obturación inalámbrico

Ref. FI-E FI-P

Rápido, ergonómico y fácil de emplear. Ideal para la realización con la técnica de onda continua. Consta de un lápiz transportador de calor y una pistola de inyección de gutapercha.



Llave Puntas Sistema de Obturación FI-E |
Ref. 28-177



Atacador Gutapercha Sistema Obturación FI-P

40mm Ø4% Ref. 28-WP4004
45mm Ø4% Ref. 28-WP4504
55mm Ø6% Ref. 28-WP5506
55mm Ø8% Ref. 28-WP5508

Punta inyección gutapercha obturador FI-E

24mm Ø4% Ref. 28-E23GM
28mm Ø4% Ref. 28-E23GL
28mm Ø6% Ref. 28-E25GL

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

OBTURACIÓN

¿Cómo usar el Horno Obturador de Gutapercha?

"Técnicas de trabajo avanzadas."



Dr. **Juanjo Gaite García**

"Práctico y sencillo."









Puntas de Gutapercha (60 Uds.)

Las puntas gutapercha están indicadas para la obturación del conductos tras la instrumentación. Podremos encontrarlas disponibles en diferentes diámetros y conicidades. Con marcas de longitud para una mayor eficiencia en el tratamiento.

Puntas Ø4%

Ø 20 Ref. PG 02004
Ø 25 Ref. PG 02504
Ø 30 Ref. PG 03004
Ø 35 Ref. PG 03504
Ø 40 Ref. PG 04004
Ø 50 Ref. PG 05004

Puntas Ø6%

Ø 20 Ref. PG 02006
Ø 25 Ref. PG02506
Ø 30 Ref. PG 03006
Ø 35 Ref. PG 03506
Ø 40 Ref. PG 04006
Ø 50 Ref. PG 05006

Gutapercha Pellets (100 Uds.)

Ref. EQV GP

Las pellets de gutapercha están indicadas para ser utilizadas con nuestro sistema de obturación inalámbrico, vienen distribuidas en cajas de 100 unidades.

Horno para obturación

Ref. HOG

- Un horno para obturación que nos permite plastificar los obturadores.
- Contiene una cámara de calor que garantiza un tiempo idóneo para iniciar la obturación.
- Ligero y cómodo para tu trabajo diario.
- Permite calentar hasta 4 obturadores al mismo tiempo.
- De fácil limpieza.

Pluggers manuales (4 Uds.)

Ref. ATE 35-120

- Ø 60 | Ø 120
- Ø 50 | Ø 100
- Ø 40 | Ø 80
- Ø 35 | Ø 70

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

“Máxima funcionalidad.”



Verificadores
(6 Uds.)

Ø 20 Ref. VT020
Ø 25 Ref. VT 025
Ø 30 Ref. VT030
Ø 35 Ref. VT035
Ø 40 Ref. VT040
Ø 45 Ref. VT045
Ø 50 Ref. VT050



Obturadores
(6 Uds.)

Ø 20 Ref. OG020
Ø 25 Ref. OG 025
Ø 30 Ref. OG030
Ø 35 Ref. OG035
Ø 40 Ref. OG040
Ø 45 Ref. OG045
Ø 50 Ref. OG050



Cemento de obturación

Ref. ENDORESIN

Cemento de resina epoxi de tipo pasta, empleado para la obturación del conducto conjuntamente con las puntas de gutapercha u obturadores de vástago de plástico.

- Biocompatibilidad según los requisitos de ISO 6876

-Baja capacidad de reabsorción

- Jeringa pre-cargada con **13,5g** *(9g de base y 4,5g de catalizador).*



EVO MTA Cemento Reparador

Ref. EVO MTA

Silicatos dicálcicos y tricálcicos. Libre de óxido de bismuto. Indicado para: protección pulpar directa, pulpotomía, cirugía apical, apicoformación, reabsociones, perforaciones...

- Contiene **1g** en polvo y **3ml** de líquido.



EVO MTA Posteriors

Ref. EVO MTA POST

MTA con óxido de bismuto como agente radiopacificador, que proporciona una elevada radiopacidad.

Especialmente indicado para la obturación ortógrada en el sector posterior y para procedimientos de cirugía apical.

- Contiene **1g** en polvo y **3ml** de líquido.

Cirugía apical



Ideales para la preparación retrógrada del conducto en la cirugía apical. Su punta recubierta de diamante facilita el trabajo y la visibilidad del clínico.

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026



Dr. **Manuel Ruiz Piñón**

“Ideales para la preparación retrógrada del conducto en la cirugía apical.”




Punta ultrasónica de 3mm de longitud para cirugía apical

Ref. EAS1

Diseñada para realizar tus tratamientos de una forma ágil y cómoda para el paciente. Reduce los tiempos de ejecución. La punta cuenta con un recubrimiento de diamante, lo que aumenta la precisión y la sensibilidad a la hora de trabajar. Long. **3mm** - Conicidad **9%.**

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026

Accesorios

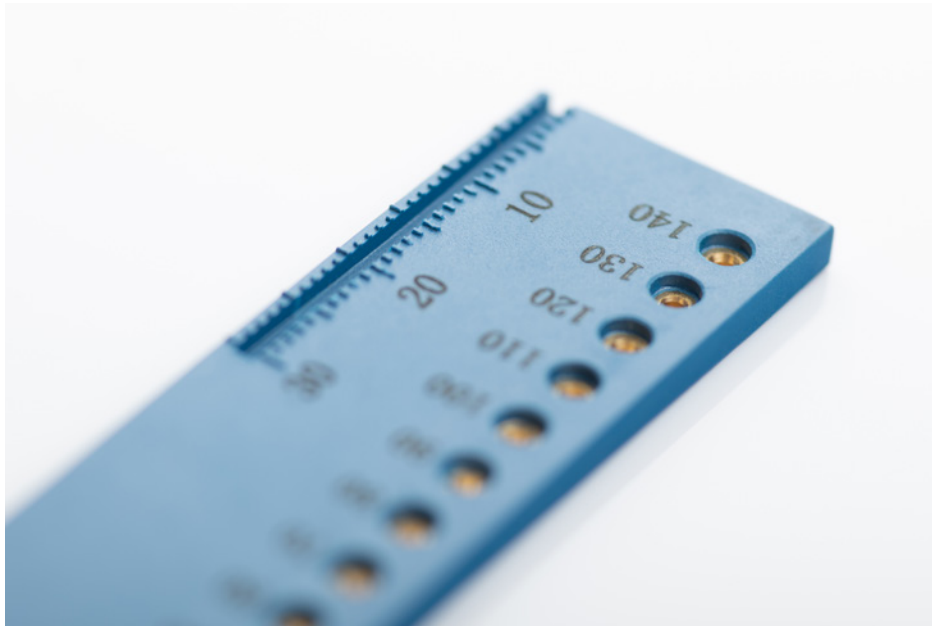

A la hora de realizar nuestros procedimientos y práctica diaria, es importante contar con **herramientas prácticas** y **cómodas** que nos faciliten y agilicen al máximo nuestro trabajo.

En este aspecto Endogal te facilita utensilios indispensables para tu práctica clínica diaria, como son nuestro **espejo** de alta definición, el **esponjero** y la **regla** para endodoncia.

"No pueden faltar en nuestra clínica dental."



Regla para calibrado

Ref. 781-001

Regla milimetrada para realizar mediciones de los instrumentos utilizados en nuestros tratamientos de endodoncia.

Orificios en base a estándar ISO para el calibrado apical de la gutapercha.



Esponjero

Ref. PP400387

Recambio de esponjas

Ref. PN180410

Utilizado para depositar las limas manuales y los instrumentos rotatorios durante el tratamiento endodóncico.



Espejo (4 Uds.)

Ref. 50Z362

Permiten ver la cámara pulpar de una forma eficaz y precisa, facilitándonos la realización del diagnóstico. Con una alta reflectividad gracias al sistema de reflexión frontal compuesto por vidrio óptico y resinas termoplásticas de alto rendimiento. Debe realizar un ciclo corto de esterilización.

Catálogo de Endogal | Versión - CAT-END-S Ver. | 11/2026



Hidróxido de calcio Endocalcium

Ref. ENDOCALCIUM

Material de relleno temporal, como medicación entre sesiones, para facilitar el éxito de la endodoncia. Suministrada con una jeringa pre-cargada de **2,2 g** de pasta.



Terauchi File Removal Kit

Ref. TFRK

Explorador dental
Ref. 28-WA024
Ref. 28-WA023

Fresa para pulido
Ref. 28-WA025

Lanza Endo Yoshi TFRK-L
Ref. 28-WA029

Punta DTE
Ref. ED87
Ref. ED88
Ref. ED89

Repuesto lazo
Ref. WA031
Ref. WA030



Endogal Training System

Ref. ENDOTRAIN

Sistema de entrenamiento en endodoncia diseñado para utilizar dientes naturales y artificiales.



Aceite Lubricante en spray MK-DENT Premium

Ref. 06-LU1011

Aceite lubricante en spray 100% sintético e incoloro para mantenimiento y lubricación de los instrumentos rotatorios.



Contenedor de Instrumentos Rotatorios

Ref. C IRE



Boquilla lubricación cabezas CA Woodpecker-DTE Endo

Ref. 28-WA013

ACCESORIOS

Endogal®

La **revolución** en **endodoncia** ha llegado.



- (+34) 982 533 493
- info@endogal.es